

PŘÍLOHA Č. 1:
Pevné kotníkové ortézy (AFO)



Obrázek převzat z: <http://www.footankle.com/drop-foot.htm>



Obrázek převzat z: <http://www.chaneco.co.uk/orthotic-product.asp?prodId=17>

PŘÍLOHA Č. 2:

Dynamické kotníkové ortézy (AFO), ortézy asistující dorzální flexi



Obrázek převzat z: <http://www.medicalexpo.com/prod/fillauer/dynamic-ankle-foot-orthoses-dafo-74954-467324.html>



Obrázek převzat z: <http://www.medicalexpo.com/prod/Ossur-uk/dynamic-ankle-foot-orthoses-dafo-74948-528089.html>



Obrázek převzat z: <http://www.medicalexpo.com/prod/otto-bock-healthcare/ground-reaction-ankle-foot-orthoses-grafo-74842-468972.html>

PŘÍLOHA Č. 3:

Kloubové kotníkové ortézy (AFO)



Obrázek převzat z: <http://www.footankle.com/drop-foot.htm>




Obrázek převzat z: <http://www.medicaexpo.com/prod/innovation-rehab/articulated-ankle-foot-orthoses-afo-74706-454550.html>



Obrázek převzat z: <http://www.medicalexpo.com/prod/rcal-restorative-care-america/articulated-ankle-foot-orthoses-afo-80500-507836.html>)

PŘÍLOHA Č. 4:

Elektrostimulátor WalkAide s manžetou

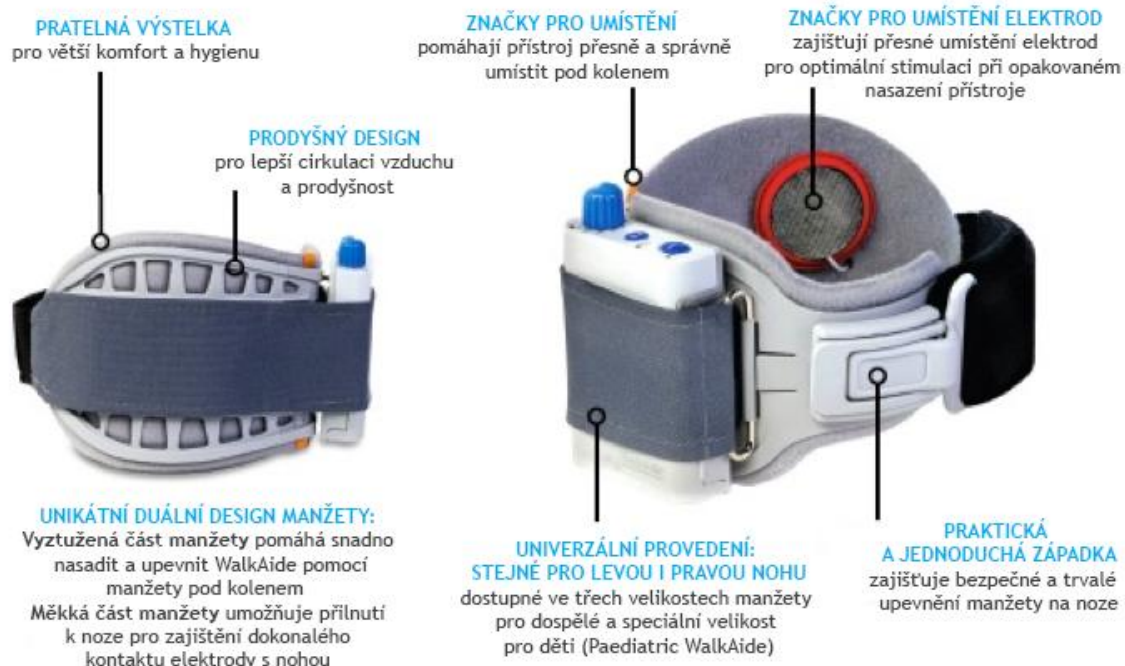

Obrázek převzat z: <http://2move.cz/index.php/co-je-walkaide>

PŘÍLOHA Č. 5:

Nastavitelné parametry stimulace v programu WalkAnalyst

Clinical Preferences

Thresholds	
Tilt On	255
Tilt Off	1
Heel On	230
Heel Off	220

Stimulus Settings	
Pulse Width (μ s)	100
Time Between (ms)	40
Frequency (Hz)	25
Extra Stimuli	0

Control Times	
Swing(Min) Time(sec)	0.5
Swing(Max) Time(sec)	1
Stance(Wait)Time(sec)	0.4
On Ramp Time (sec)	0
Off Ramp Time (sec)	0

Exercise Settings	
On Time (Seconds)	2
Off Time (Seconds)	2
Duration (Minutes)	5

Filter Setting	
Filter Setting	4

Program WalkAnalyst 4, záložka Clinical Preferences