


ERRATA

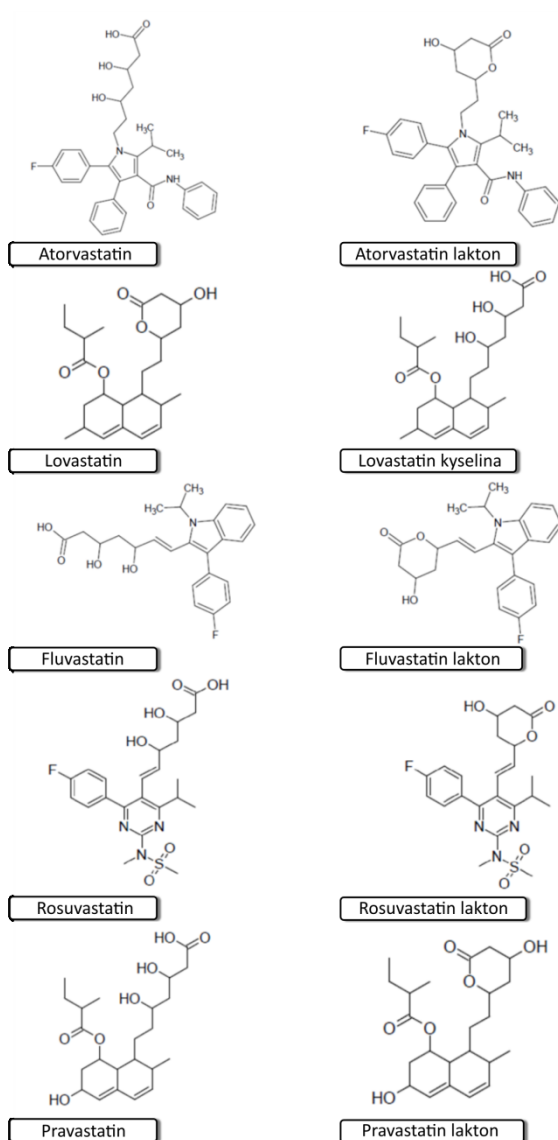

Oprava str. 44: Oprava obrázku 23 u názvu Lovastatin lakton na správný název Lovastatin kyselina.

Oprava str. 51: Oprava v kapitole **4.7 Hodnocení linearity a citlivosti** v prvním odstavci.

Upraven rozsah z hodnot 100-0,01 ng/ml na hodnoty 100-0,02 ng/ml.